


Osteotomia para fêmur e tíbia

Fixação rígida 4.5/5.0mm



TORIDE[®]

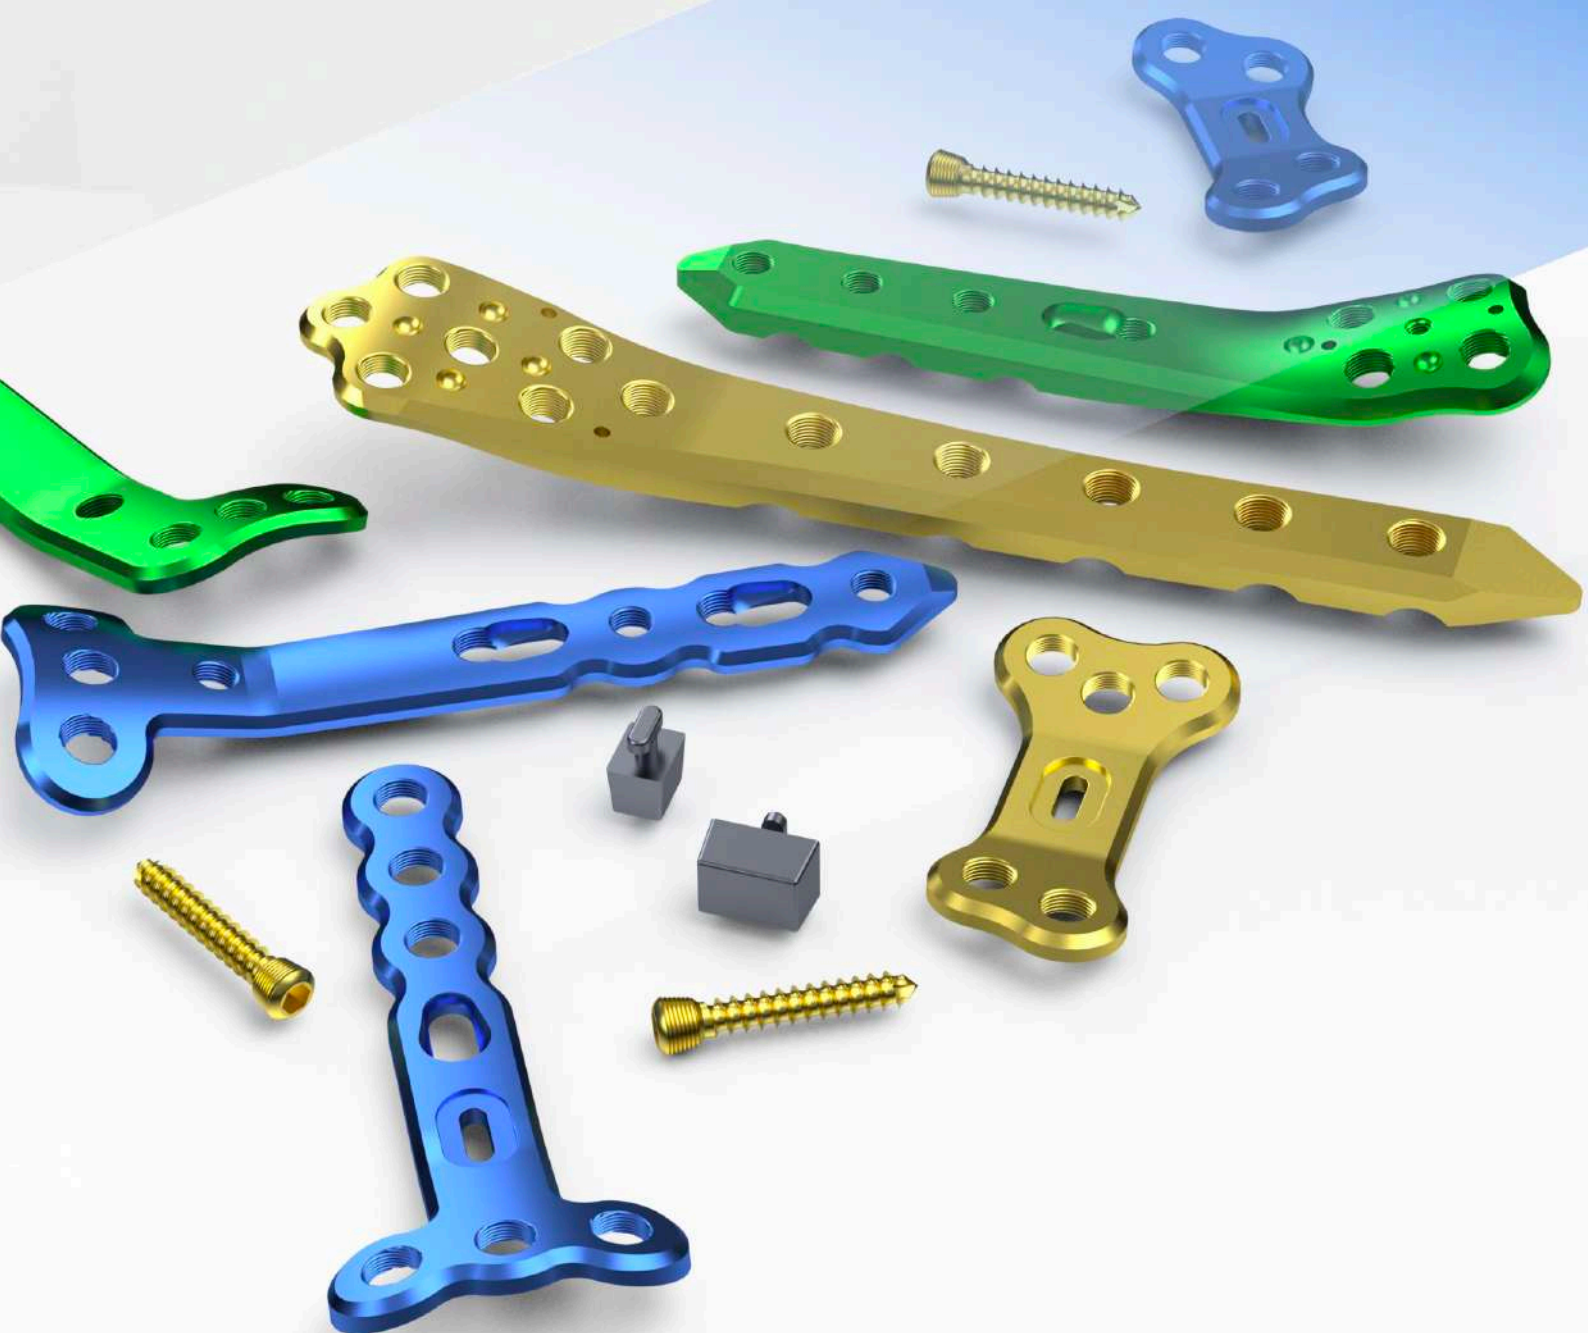

Comprometimento e qualidade são os alicerces que constroem nossos mais de 20 anos de experiência no mercado fabricando produtos para a saúde. Iniciamos a nossa história com a fabricação de implantes para mini micro fragmentos.

Hoje, expandimos essa expertise e nos tornamos referência nacional no desenvolvimento de soluções para osteossíntese e instrumentais cirúrgicos. Essa evolução é resultado do comprometimento da nossa equipe e de investimentos em nosso parque industrial que possui mais de 4.100 m².



Investimento no parque fabril com mais de 3.300 m² de área produtiva, com equipamentos modernos.



Equipamentos de controle dimensionais de última geração.





Estojo de Parafusos
Sistema Osteotomia
30.00.134

TORIDE®

PARAFUSOS

Titânio 6% Alumínio/4% Vanádio



Parafuso Cortical Ø 4.5
com sextavado

ANVISA 80084420014


| Ø | Ref N.º |
|-------------|------------------|
| 4.5 X 30 mm | 136.45.03.19.030 |
| 4.5 X 32 mm | 136.45.03.19.032 |
| 4.5 X 34 mm | 136.45.03.19.034 |
| 4.5 X 36 mm | 136.45.03.19.036 |
| 4.5 X 38 mm | 136.45.03.19.038 |
| 4.5 X 40 mm | 136.45.03.19.040 |
| 4.5 X 42 mm | 136.45.03.19.042 |
| 4.5 X 44 mm | 136.45.03.19.044 |
| 4.5 X 46 mm | 136.45.03.19.046 |
| 4.5 X 48 mm | 136.45.03.19.048 |
| 4.5 X 50 mm | 136.45.03.19.050 |
| 4.5 X 54 mm | 136.45.03.19.054 |
| 4.5 X 56 mm | 136.45.03.19.056 |
| 4.5 X 60 mm | 136.45.03.19.060 |



Parafuso Ø 4.5
FR com sextavado

ANVISA 80084420019

| Ø | Ref N.º |
|-------------|-------------|
| 4.5 X 24 mm | 45.0315.024 |
| 4.5 X 26 mm | 45.0315.026 |
| 4.5 X 28 mm | 45.0315.028 |
| 4.5 X 30 mm | 45.0315.030 |
| 4.5 X 32 mm | 45.0315.032 |
| 4.5 X 34 mm | 45.0315.034 |
| 4.5 X 36 mm | 45.0315.036 |
| 4.5 X 38 mm | 45.0315.038 |
| 4.5 X 40 mm | 45.0315.040 |
| 4.5 X 42 mm | 45.0315.042 |
| 4.5 X 44 mm | 45.0315.044 |
| 4.5 X 46 mm | 45.0315.046 |
| 4.5 X 48 mm | 45.0315.048 |
| 4.5 X 50 mm | 45.0315.050 |
| 4.5 X 54 mm | 45.0315.054 |
| 4.5 X 56 mm | 45.0315.056 |
| 4.5 X 60 mm | 45.0315.060 |
| 4.5 X 64 mm | 45.0315.064 |
| 4.5 X 66 mm | 45.0315.066 |
| 4.5 X 70 mm | 45.0315.070 |
| 4.5 X 74 mm | 45.0315.074 |
| 4.5 X 76 mm | 45.0315.076 |
| 4.5 X 80 mm | 45.0315.080 |
| 4.5 X 84 mm | 45.0315.084 |
| 4.5 X 86 mm | 45.0315.086 |
| 4.5 X 90 mm | 45.0315.090 |

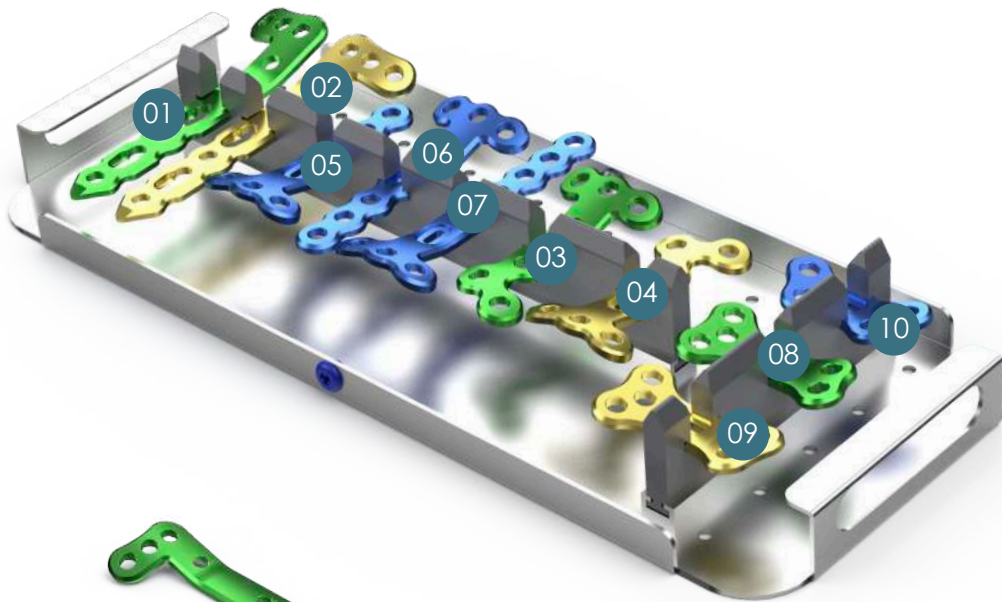

01



Placa FR "L" Direita para Tíbia P

Código
45.5031.001

ANVISA
80084420019

QTD.
01

02



Placa FR "L" Esquerda para Tíbia P

Código
45.5031.002

ANVISA
80084420019

QTD.
01

03



Placa "T" FR de Osteotomia "D"
para Tíbia – G

Código
35.3542.001

ANVISA
80084420019

QTD.
01

04



Placa "T" FR de Osteotomia "E"
para Tíbia – G

Código
35.3542.002

ANVISA
80084420019

QTD.
01

05



Placa "T" FR de Osteotomia
para Tíbia 5 Furos – G

Código
35.3545.000

ANVISA
80084420019

QTD.
01

06



Placa "T" FR de Osteotomia
para Tíbia 6 Furos – G

Código
35.3548.000

ANVISA
80084420019

QTD.
01

07



Placa "T" FR de Osteotomia
para Tíbia 7 Furos – G

Código
35.3551.000

ANVISA
80084420019

QTD.
01

08



Placa FR de Osteotomia
"D" para Tíbia 5 Furos – M

Código
35.3554.001

ANVISA
80084420019

QTD.
01

09



Placa FR de Osteotomia "E"
para Tíbia 5 Furos - M

Código
35.3554.002

ANVISA
80084420019

QTD.
01

10




Placa FR de Osteotomia para
Tíbia 4 Furos M

Código
35.3553.000

ANVISA
80084420019

QTD.
01

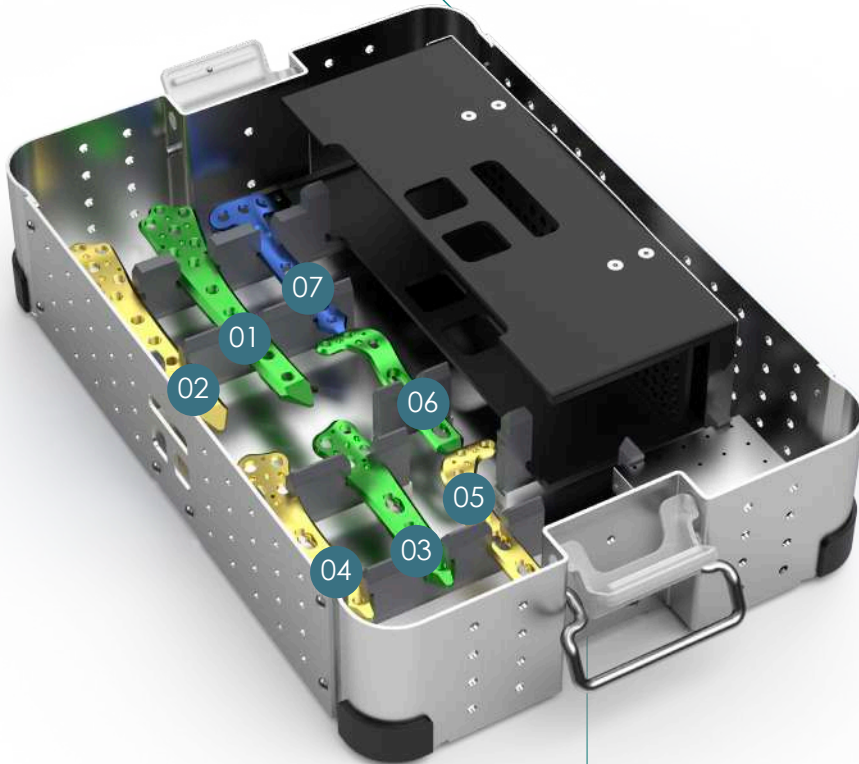

Caixa de implantes

| | | | | | |
|----|--|--|------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01 | | Placa FR Fêmur Distal Lateral "D" P | Código 45.5001.001 | ANVISA 80084420019 | QTD. 01 |
| 02 | | Placa FR Fêmur Distal Lateral "E" P | Código 45.5001.002 | ANVISA 80084420019 | QTD. 01 |
| 03 | | Placa FR Osteotomia Fêmur Distal Medial P "D" | Código 1.67.50.23.11.171 | ANVISA 80084420019 | QTD. 01 |
| 04 | | Placa FR Osteotomia Fêmur Distal Medial P "E" | Código 1.67.50.22.11.171 | ANVISA 80084420019 | QTD. 01 |
| 05 | | Placa de Osteotomia Proximal "D" 5 Furos FR para Tíbia P | Código 35.3555.001 | ANVISA 80084420019 | QTD. 01 |
| 06 | | Placa de Osteotomia Proximal "E" 5 Furos FR para Tíbia P | Código 35.3555.002 | ANVISA 80084420019 | QTD. 01 |
| 07 | | Placa FR "T" para Tíbia P | Código 45.5012.000 | ANVISA 80084420019 | QTD. 01 |



Estojo de Calço 9mm
Osteotomia
30.00.132



Conjunto Calço 9 x 5mm
para Placa de Osteotomia
35.0009.005



Conjunto Calço 9 x 7mm
para Placa de Osteotomia
35.0009.007



Conjunto Calço 9 x 9mm
para Placa de Osteotomia
35.0009.009



Conjunto Calço 9 x 11mm
para Placa de Osteotomia
35.0009.011




Conjunto Calço 9 x 13mm
para Placa de Osteotomia
35.0009.013



Conjunto Calço 9 x 15mm
para Placa de Osteotomia
35.0009.015

INSTRUMENTAL

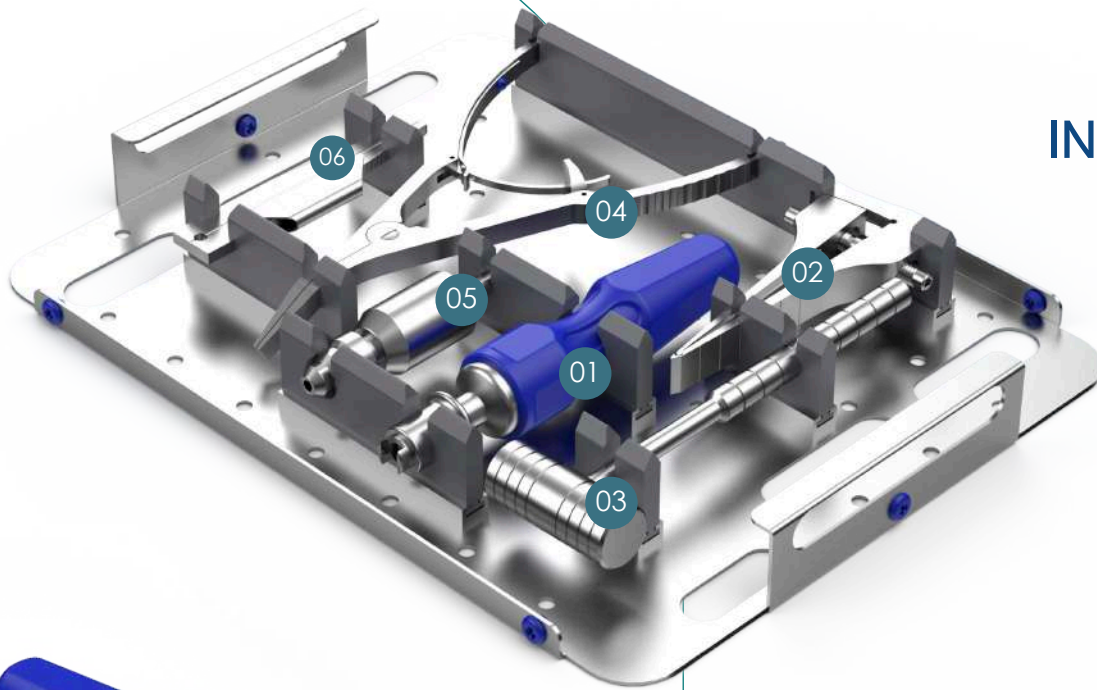


Bandeja 01



| | Código | ANVISA | QTD. |
|----|-----------|-------------|------|
| 01 | 09.00.078 | 80084420025 | 01 |

Cabo de chave

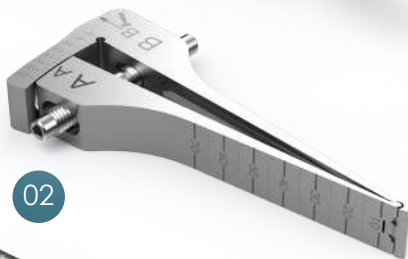

| | Código | ANVISA | QTD. |
|----|-----------|-------------|------|
| 02 | 38.00.012 | 80084420025 | 01 |

Espaçador Ósseo Graduado



| | Código | ANVISA | QTD. |
|----|-----------|-------------|------|
| 03 | 37.00.008 | 80084420025 | 01 |

Martelo



| | Código | ANVISA | QTD. |
|----|-----------|-------------|------|
| 04 | 20.00.010 | 80084420024 | 01 |

Afastador Spreader




| | Código | ANVISA | QTD. |
|----|-----------|-------------|------|
| 05 | 42.00.003 | 80084420025 | 01 |

Limitador de Torque 4.0 Nm



| | Código | ANVISA | QTD. |
|----|-----------|-------------|------|
| 06 | 38.00.013 | 80084420025 | 01 |

Medidor de Abertura

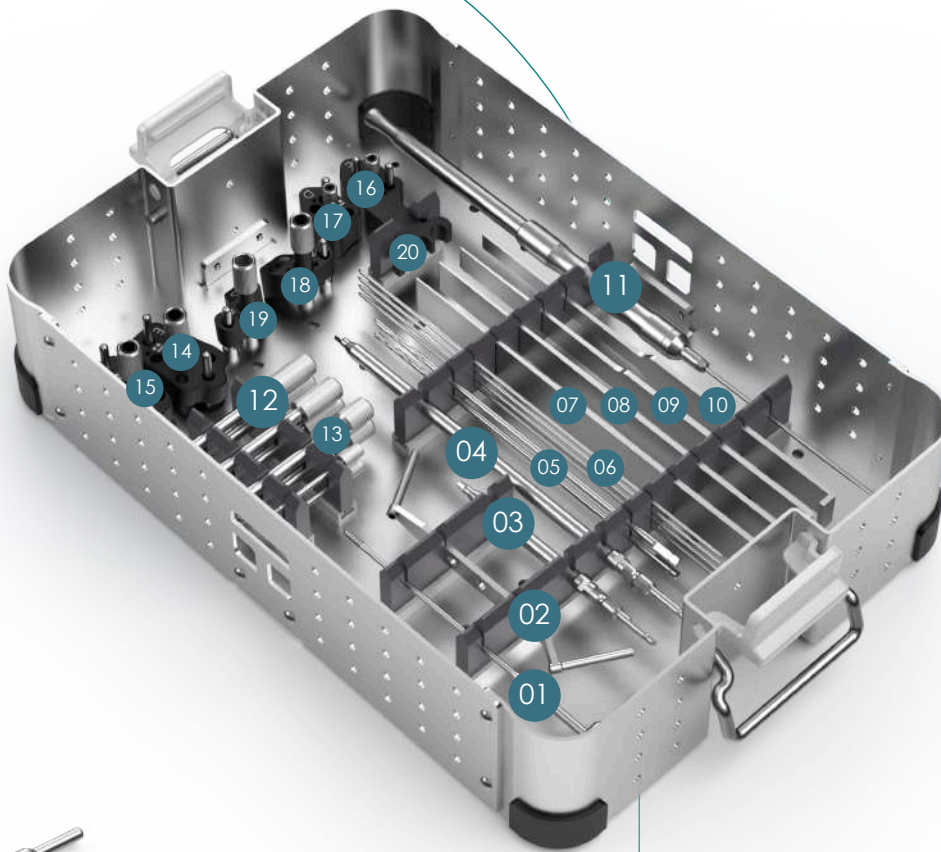

Caixa



01

Macho para Parafuso Ø4,5

Código
06.00.074

ANVISA
80084429003

QTD.
01



02

Conjunto Guia de Broca Ø4,5/5,0
Ponta Serrilhada

Código
130994550118

ANVISA
80084420015

QTD.
01



03

Ponta de Chave Sextavada 130 mm

Código
08.00.073

ANVISA
80084420025

QTD.
01



04

Ponta de Chave Sextavada 240 mm

Código
08.00.074

ANVISA
80084420025

QTD.
01



05

Broca Ø3,5 x 210mm Linha
Grandes Fragmentos

Código

1.34.05.35.50.210

ANVISA

80084420015

QTD.

02



06

Fio Guia Liso Ø2,0

Código

138052050250

ANVISA

80084420015

QTD.

04



07

Osteotomo 25mm

Código

52.00.015

ANVISA

80084420033

QTD.

01



08

Osteotomo 20mm

Código


52.00.014

ANVISA

80084420033

QTD.

01

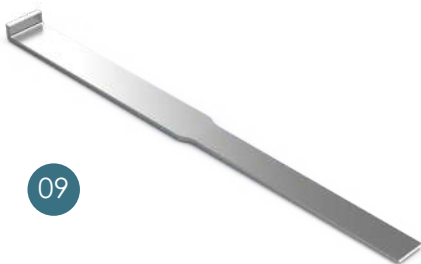

09

Osteotomo 15mm

Código

52.00.013

ANVISA

80084420033

QTD.

01



10

Osteotomo 10mm

Código

52.00.012

ANVISA

80084420033

QTD.

01



11

| | Código | ANVISA | QTD. |
|----------------------------------|--------------|-------------|------|
| Medidor Linha Grandes Fragmentos | 130991245168 | 80084420015 | 01 |



12

| | Código | ANVISA | QTD. |
|---------------------------|-----------|-------------|------|
| Cânula Guia de Broca Ø3,5 | 11.00.102 | 80084420025 | 04 |



13

| | Código | ANVISA | QTD. |
|-------------------------|-----------|-------------|------|
| Cânula Guia de Fio Ø2,0 | 11.00.103 | 80084420025 | 02 |



14

| | Código | ANVISA | QTD. |
|--|-----------|-------------|------|
| Bloco Guia para Placa FR Fêmur Distal Lateral Esquerda | 23.00.044 | 80084420028 | 01 |



15

| | Código | ANVISA | QTD. |
|---|-----------|-------------|------|
| Bloco Guia para Placa FR Fêmur Distal Lateral Direita | 23.00.045 | 80084420028 | 01 |



16

| | Código | ANVISA | QTD. |
|--|-----------|-------------|------|
| Bloco Guia para Placa FR Osteotomia Fêmur Distal Medial Esquerda | 23.00.046 | 80084420028 | 01 |

17



Bloco Guia para Placa FR
Osteotomia Fêmur Distal
Medial Direita

Código
23.00.047

ANVISA
80084420028

QTD.
01

18



Bloco Guia para Placa de
Osteotomia Proximal Esquerda
5 Furos FR para Tíbia

Código
23.00.048

ANVISA
80084420028

QTD.
01

19



Bloco Guia para Placa de
Osteotomia Proximal Direita
5 Furos FR para Tíbia

Código
23.00.049

ANVISA
80084420028

QTD.
01

20



Bloco Guia para Placa "T" FR
de Osteotomia para Tíbia

Código
23.00.050

ANVISA
80084420028

QTD.
01

TORIDE®

Fabricado por:

TÓRIDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Av. Caetano Schincariol, Nº 97, Parque das Empresas
Mogi Mirim - São Paulo - Brasil - CEP: 13803-340



toride.com.br